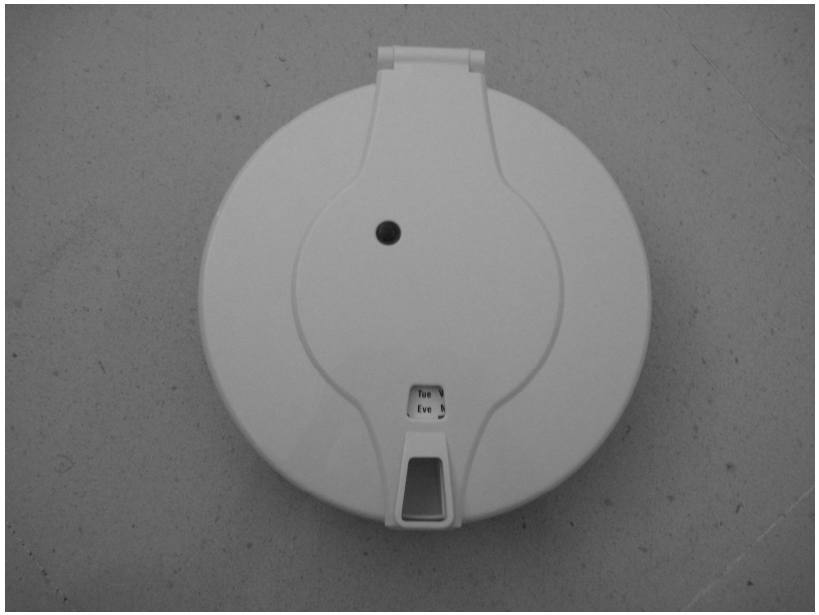

Plurimed-e-lert

Manual de Instruções

Mantenha o dispensador de comprimidos
afastado da luz solar/ ultravioleta, directa,
a fim de evitar eventuais avarias.

www.simplemed.pt

1. Colocar as pilhas

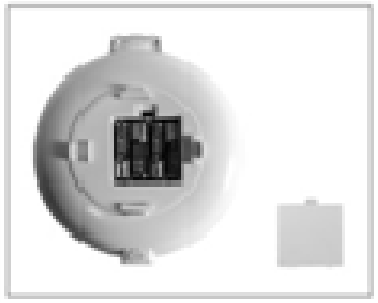

Insira 4 pilhas AA no compartimento das pilhas
Tendo em atenção os pólos positivo e negativo.

2.Como Abrir o Plurimed-e-lert

Pressione suavemente o botão branco localizado no lado externo
do compartimento de medicamentos

3.Como limpar o compartimento de medicamentos

Limpe somente com um pano ou uma esponja húmida.

4. Como carregar o compartimento de comprimidos

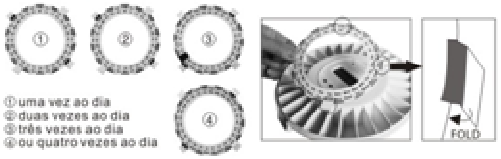



Encontram-se disponíveis quatro discos de cartão móveis que indicam o dia da semana e o número de doses diárias.

Estes deverão ser utilizados consoante a frequência diária da toma de comprimidos. Uma vez ao dia, duas , três ou 4 vezes .

. Escolha o disco correspondente á sua necessidade diária e posicione sobre o compartimento dos comprimidos, curvando as abas existentes para dentro dos nichos existentes a fim de garantir a fixação do disco escolhido. Organizar os comprimidos de modo que cada comprimido esteja posicionado no compartimento apropriado é de sua responsabilidade. Siga rigorosamente a recomendação médica referente a doses e horários de ingestão do seu medicamento.

A frequência de reposição dos comprimidos no compartimento depende do número de vezes ao dia que você necessita de os tomar. Para 1 comprimido por dia será necessária reposição somente após 28 dias. Para 2 comprimidos por dia será necessária reposição após 14 dias. Para 3 comprimidos por dia será necessária reposição após 9 dias. Para 4 comprimidos por dia será necessária reposição após 7 dias.

11. Como desligar o alarme



Para desligar o alarme do dispositivo, incline a caixa doseadora para esvaziar o compartimento dos comprimidos na sua mão ou num outro recipiente.

12. Aviso de pilhas fracas



Assim que no ecrã surgir um símbolo com uma pilha com um X, está na hora de substituir as pilhas.

Simplemed , Unip. Lda
Praceta dos Lilases, 18 Birre
2750-245 Cascais
Lisboa
Email:geral@simplemed.pt
www.simplemed.pt

5.Configurar o formato de Hora -12/24

O distribuidor de comprimidos Plurimed-e-lert, vem configurado de fábrica para o formato de 24 horas.Para o por a funcionar nun formato de 12 horas pressione simultaneamente os botões2 e 3 por alguns instantes. A opção AM/Pm aparecerá do lado direito do botão. Solte os botões 2 e 3 quando a opção desejada estiver no ecrã.

6. Ajustando o relógio

(Botão 1 Esquerda, Botão 2 Centro, Botão 3 Direita)

1 -Pressione o botão 1 até aparecer " : "

Blink

2 - Pressione o botão 2 para ajustar a hora e o botão 3 para ajustar os minutos

Blink

Ajustar hora

3- Pressione novamente o botão 3 para salvar a alteração efectuada

Blink

Ajustar minutos

7. Ajustar os alarmes

1- Pressione levemente o botão 1 para programar o alarme 1 (o símbolo do alarme irá aparecer no ecrã). Em seguida pressione o botão 2 para configurar o horário desejado para o alarme 1 e o botão 3 para configurar os minutos desejados para o alarme 1. Se desejar desligar o alarme, pressione várias vezes o botão 2 até aparecer o símbolo **"--:--** ", após as 23:00 ou 11:00 PM.

2 - Após a programação do horário desejado do alarme 1 pressione novamente o botão para salvar a configuração do alarme 1 e iniciar a configuração do alarme 2.

3 - Pressione o botão para configurar o horário desejado para o alarme2 e o botão 3 para configurar os minutos para o alarme 2. Pressione novamente o botão 2 para confirmar as configurações do alarme 2.

4 - Para configurar o alarme 3 e 4 sigas os passos anteriores.

5– Para finalizar, após a configuração dos alarmes necessários, pressione o botão 1 até desaparecer o símbolo dos alarmes.

Nota: Se mantiver pressionados simultaneamente os botões da hora e dos minutos, o ajuste da hora será feito de forma crescente. Caso os botões não estejam pressionados o sistema voltará ao modo normal dentro de um minuto.

8. Tons de alarme



O doseador de comprimidos Plurimed tem 3 tipos diferentes de alarme e ainda a opção de modo silêncio. Os símbolos "A", "B" e "A+B" indicam os diferentes tons de alarme disponíveis. Quando nenhum dos símbolos aparece no ecrã o alarme está na posição – silêncio-.

Para seleccionar uma das opções de alarme sonoro pressione ao mesmo tempo o botão 3 e o botão 1 para escolher o tom desejado. Mantenha esse procedimento até decidir qual o tom que prefere.

9. Modulo de teste



O Doseador possui uma função interna que permite testar as funções do sistema. Para activar esse modo pressione o botão 1 durante 12 segundos e o símbolo "CH" aparecerá no ecrã. Para sair do modo de teste pressione a tecla 3.

Modo de teste "CH"

Quando exibido o símbolo " CH" o sistema estará pronto para o inicio dos testes. Para iniciar os testes pressione o botão 2.

Teste mecânico de Ecrã CH1

Quando activa a opção "CH1", o sistema activará todos os recursos do ecrã.

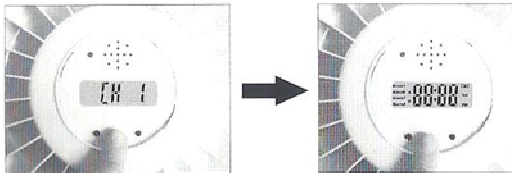

Teste mecânico – "CH2"

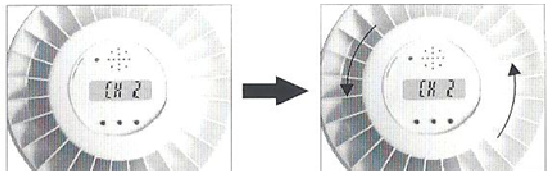

Quando activada a opção CH2, o sistema irá girar o disco dos comprimidos até ao próximo compartimento.

Teste de sinal de alarme do despertador –" CH3"

A Luz ficará vermelha (acende-se o LED)

Quando activada a opção CH3, o sistema emite o som e acende o LED. Para interromper o alarme e desligar o led gire o aparelho simulando a retirada do comprimido. A opção CH4 aparecerá no ecrã caso o sistema não seja desactivado em 10 segundos

Caso o motor não gire correctamente o disco dos comprimidos, o ecrã exibirá a opção "CH6". Pressione a tecla 3 para sair do teste

Para reiniciar o sistema retire as pilhas e volte a colocá-las.

10. Como fechar á chave e abrir o equipamento.

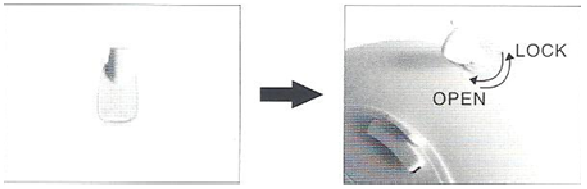

Insira a chave e gire para o lado esquerdo por ¼ para fechar o equipamento. Gire para o lado direito por ¼ para abrir a unidade.